

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12
Фактический адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, литер В, Б, Д
Телефон/факс +7(4932)-23-47-05/+7(4932)-23-06-06, e-mail: 37fguz@345000.ru
ОКПО 75902430 ОГРН 1053701048378 ИНН/КПП 3702068421/370201001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510134



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
В.В. Булыгина
21 октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8053 от 21 октября 2021 г.

Наименование образца испытаний: Вода из колодца
Образцы испытаний отобраны: гл. спец. Толокнов А.С.
Дата и время отбора образца: 30.09.2021г. 7-00
Дата и время доставки образца: 30.09.2021г. 11-00
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо, у которого отобраны образцы: администрация Новоталицкого сельского поселения, с. Ново-Талицы, ул. 2 Шимановская, д. 6
Объект, где проводился отбор образцов: с. Ново-Талицы, ул. 2 Яковлевская -колодец
Код образца:

К 30.09.21.2608.3X

Изготовитель: -

Дата изготовления: 29.03.2021г. Номер партии: - Объем партии:-

Тара, упаковка: бутылки 50 л./0,5 л. /1,5л./0,5л.

НД на методы отбора: -

Условия транспортировки: автотранспорт


Дополнительная информация: полученные результаты испытаний, отраженные в данном протоколе, относятся только к предъявленному заказчиком образцу

Специалист, ответственный за оформление протокола _____ Скороходова Н.П.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Код образца (пробы):

К 30.09.21.2608.3X

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:					
№	Определяемые показатели	Результаты измерений	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	9±3	30	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,6±0,3	2,6	ЕМ/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Наименование оборудования			Инвентарный номер		Год ввода в эксплуатацию
Спектрофотометр ПЭ-5400 В			01380930		2013
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Химик-эксперт		Майданкина М.А.			
Лаборант		Корзенева Т.Д.			
Ф.И.О. заведующей лабораторией Мутовкина М.В.....Подпись..... 					
			Страница: 2		
Ф 05-03-01-01-2021					

Код образца (пробы)

К- 30.09.21. 2608. 3X

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ					
Регист- рацион- ный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиеничес- кий норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1320	Общее микробное число	61	Не более 100	КОЕ/мл	МУК 4.2. 1018-01 (с изменением №2 МУК 4.2.3690-21)
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии в 100мл	ОБНАРУЖЕНЫ	Отсутствие	-	
	Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл	ОБНАРУЖЕНЫ	Отсутствие	-	

Оборудование:

1. Термальная комната №315

Срок очередной периодической аттестации – до 15 июля 2022г

Год ввода в эксплуатацию - 2015

2. Термостат ТС-80 М-2 №163

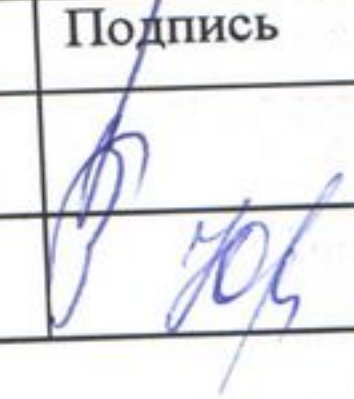
Инвентарный номер - 01350623

Срок очередной периодической аттестации – до 15 февраля 2023г

Год ввода в эксплуатацию – 1989

Начало исследования: 30.09.21г Окончание исследования: 04.10.21г

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кропотина ТА	
Фельдшер-лаборант	Юрцева ЕМ	

Ф.И.О. заведующего МБЛ Тихонова ЕВ.....

Подпись

Страница 3

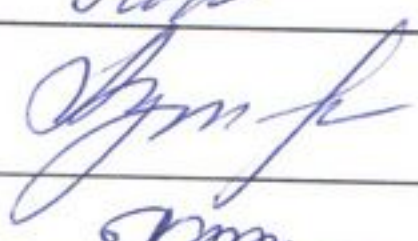

Ф 05-03-01-01-2021

Код пробы:

К 30.09.21.2608.3 X

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив	Единицы измерений (для граф 3,4,5)	НД на методы исследования
1	Удельная суммарная альфа-активность	Менее 0.097	—	0.2	Бк/кг (л)	МРК ФГУП «ВИМС» 2013
2	Удельная суммарная бета-активность	Менее 0.260	—	1.0	Бк/кг (л)	МРК ФГУП «ВИМС» 2013

Наименование средства измерения, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		Номер	Дата поверки	
Альфа-бета-радиометр УМФ-2000, инв. № 01380996, 2014	№1442	№С-ВОВ/03-08- 2021/83763276	03.08.2021	02.08.2022
Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад» Инв.№01330463 –Б,№01350048 -Г 2020	№ 2034	№ С-ВОВ/23-07- 2021/81214762	23.07.2021	22.07.2022

Ответственные за измерения	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий радиологической лабораторией	Даричева О.А.	
Химик-эксперт медицинской организации	Шулайкина Ю.Г.	
Эксперт-физик по контролю за ионизирующим и неионизирующим излучением	Афинеевская О.В.	
Фельдшер-лаборант	Рожкина Н.Л.	

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф 03-05-41-01-2021

Страница

4

Код образца (пробы):

К 30.09.21.2608.3X

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1101	Цисты лямблий; яйца гельминтов; личинки гельминтов	Не обнаружены	отсутствие	50 литров	МУК 4.2.2314-08

Начало исследование: 30.09.21

Окончание исследования: 07.10.2021

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Герасимова Н.А.	

Зав. МБЛ

Тихонова Е.В.

Подпись

страница 

Ф 05-03-01-01-2021